
# *Modello standard, risoluzione 0,001 mm, corsa di misura 5 mm*




01419055

| | |
|---|---|
| Norma | Dimensioni: ISO 463<br>Prestazioni: norma del costruttore |
| Corsa di misura | 5 mm |
| Risoluzione | 0,001 mm |
| Materiale | Cassa: metallica<br>Gambo di fissaggio: inox<br>Asta di misura: inox |
| Dimensioni | Filettatura contatti: M2,5<br>Gambo di fissaggio: Ø 8 mm |
| Grado di protezione | IP40 |
| Quadrante | Quadrante girevole<br>Indicatori di tolleranza regolabili |
| Senso di lettura | Orario |
| Unità | mm |
| Compreso nella fornitura | Comparatore con contatto a sfera Ø 3,175 mm montato<br>Dichiarazione di conformità |

## Comparatori analogici, metrici

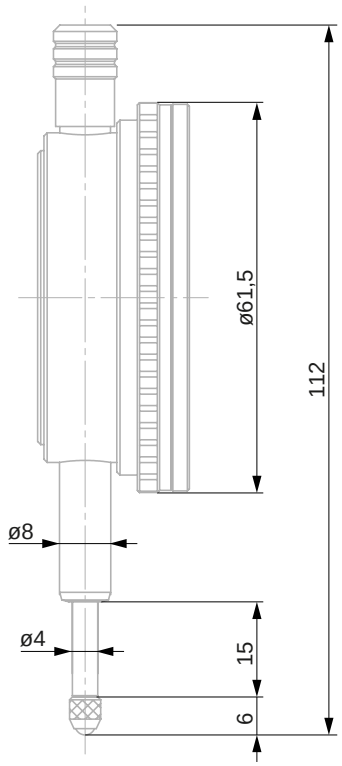


01419055

| Codice articolo | Ø Quadrante mm | Corsa / giro mm | Scala circolare | Grado di protezione | Dispositivo antiurto | Forza di misura N | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01419055** | 61,5 | 0,2 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | IP40 | Con | 1,4 ± 20% | Quadrante interno: bianco<br>Quadrante esterno: giallo<br>Numeri: neri |

| Codice articolo | MPEe, asta in entrata µm | MPEp 1/2 µm | MPEp 1/10 µm | MPEh µm | MPEr µm |
|---|---|---|---|---|---|
| **01419055** | 10 | 4 | 3 | 3 | 0,5 |

MPEe: errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (asta in entrata)
MPEp 1/10: errore d'indicazione parziale su 1/10 di giro
MPEp 1/2: errore d'indicazione parziale su 1/2 giro
MPEr: ripetibilità dell'errore d'indicazione
MPEh: isteresi dell'errore d'indicazione

*Accessori*

| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| **01960005** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura |
| **03540104** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con corsa < 5 mm |
| **03560005** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatore con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm |
| **01462005** | Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm |

## *Comparatori analogici metrici*


| Codice articolo | Risoluzione, mm | Corsa di misura, mm | Quadrante Ø, mm | Corsa / giro, mm | Scala circolare | Senso di lettura | Grado di protezione | Disp. antiurto | Quadrante girevole | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0141760500** | 0,1 | 10 | 40 | 10 | 0 ÷ 5 ÷ 10 | Orario | IP40 | | • | Standard |
| **0141760501** | 0,1 | 10 | 58 | 10 | 0 ÷ 5 ÷ 10 | Orario | IP40 | | • | Standard |
| **0141760503** | 0,1 | 30 | 58 | 10 | 0 ÷ 5 ÷ 10 | Orario | IP40 | | • | Standard |
| **0141760566** | 0,01 | 3 | 40 | 0,5 | 0 ÷ 25 ÷ 50 | Orario | IP40 | • | • | Asta dorsale |
| **01419080** | 0,01 | 3,5 | 28 | 0,5 | 0 ÷ 25 ÷ 50 | Orario | IP40 | | • | Standard |
| **01419047** | 0,01 | 5 | 40 | 0,5 | 0 ÷ 25 ÷ 50 | Orario | IP40 | • | • | Standard |
| **01419081** | 0,01 | 5 | 44.5 | 0,5 | 0 ÷ 25 ÷ 50 | Orario | IP67 | • | • | Standard |
| **01419048** | 0,01 | 10 | 58 | 1 | 0 ÷ 50 ÷ 100 | Orario | IP40 | • | • | Standard |
| **01419082** | 0,01 | 10 | 61.5 | 1 | 0 ÷ 50 ÷ 100 | Orario | IP67 | • | • | Standard |
| **0141760651** | 0,01 | 30 | 58 | 1 | 0 ÷ 50 ÷ 100 | Orario | IP40 | | • | Standard |
| **0141760661** | 0,01 | 50 | 58 | 1 | 0 ÷ 50 ÷ 100 | Orario | IP40 | | • | Standard |
| **01419056** | 0,002 | 3 | 44.5 | 0,2 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | Orario | IP40 | • | • | Standard |
| **01419057** | 0,002 | 3 | 44.5 | 0,2 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | Orario | IP67 | • | • | Standard |
| **01419058** | 0,002 | 5 | 58 | 0,2 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | Orario | IP40 | • | • | Standard |
| **01419051** | 0,001 | 0,1 | 62 | | 50 ÷ 0 ÷ 50 | Orario ed antiorario | IP40 | • | | Standard |
| **01419052** | 0,001 | 0,1 | 62 | | 50 ÷ 0 ÷ 50 | Orario ed antiorario | IP54 | • | | Standard |
| **01419053** | 0,001 | 1 | 40 | 0,2 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | Orario | IP40 | • | • | Standard |
| **01419054** | 0,001 | 1 | 58 | 0,2 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | Orario | IP40 | • | • | Standard |
| **01419055** | 0,001 | 5 | 58 | 0,2 | 0 ÷ 10 ÷ 20 | Orario | IP40 | • | • | Standard |

## *Dispositivi di sollevamento dell'asta di misura*



01960005


| Codice articolo | Descrizione | Compatibilità |
|---|---|---|
| **03540104** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con corsa < 5 mm | Per comparatori con corsa < 5 mm |
| **01961012** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC COMPACT | Per comparatori DIALTRONIC COMPACT |
| **01960005** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura | |
| **03560004** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm | Per comparatori con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm |
| **03560005** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm | Per comparatori con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm |
| **01960101** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC 12,5 mm | Per comparatori DIALTRONIC 12,5 mm |
| **01960102** | Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC 25 mm | Per comparatori DIALTRONIC 25 mm |

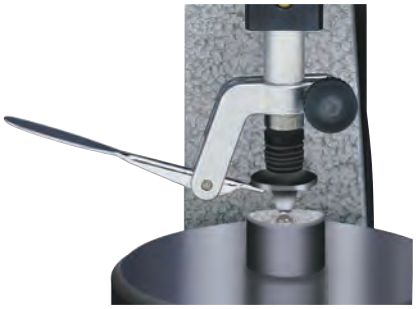

03540104




01961012

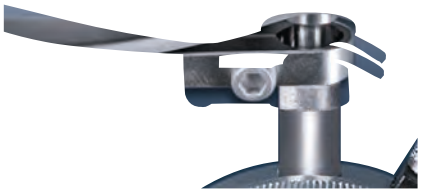

03560004 e 03560005



01960101



01960102

## *Coperchio di fissaggio per comparatori DIALTRONIC*



01960100


| Codice articolo | Descrizione | Compatibilità | Caratteristica particolare |
|---|---|---|---|
| **01960100** | Coperchio di fissaggio con occhiello centrato per comparatori DIALTRONIC | Per comparatori DIALTRONIC | Occhiello centrato |

## *Coperchi di fissaggio per comparatori analogici*



01462004

| Codice articolo | Descrizione | Diametro mm | Compatibilità | Composto da | Caratteristica particolare |
|---|---|---|---|---|---|
| **01462004** | Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm | 34 | Per comparatori analogici IP40, quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm | Coperchio di fissaggio 3x viti M1,5 x 4 mm | Occhiello centrato |
| **01462005** | Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm | 46 | Per comparatori analogici IP40, quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm | Coperchio di fissaggio 3 viti M2 x 4 mm | Occhiello centrato |
| **01460020** | Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP67 con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm | 41 | Per comparatori analogici IP67, quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm | Coperchio di fissaggio 3x viti M2 x 6 mm | Occhiello centrato |
| **01460021** | Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP67 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm | 55 | Per comparatori analogici IP67, quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm | Coperchio di fissaggio 3x viti M3 x 5,5 mm | Occhiello centrato |

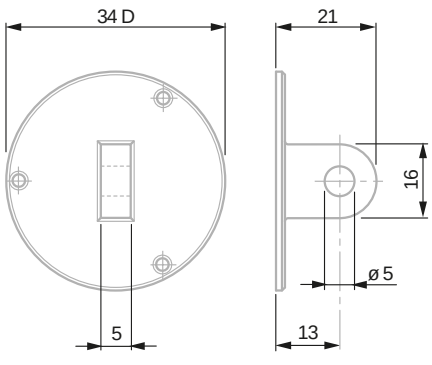


01462004